

Produkty ADR




BIOMAGNETICA

Spis treści

ADR-4	1
Urządzenie medyczne do stymulacji magnetycznej (dolegliwości bólowe) oraz do zmiany właściwości fizycznych wody. Polecane w profilaktyce i m.in. przy zaburzeniach krążenia, chorobach nerek, cukrzycy.	
ADR PROTECT	8
Osobisty stymulator magnetyczny dla poprawy krążenia oraz odporności na szkodliwe wpływy smogu elektromagnetycznego.	
MATY ADR	10
Ekrany chroniące przed polami elektromagnetycznymi.	
NAGRODY	13
Ważniejsze wyróżnienia zdobyte przez produkty i Technologię ADR na światowych wystawach wynalazczości.	

Produkty ADR to w pełni polskie wynalazki stworzone przez naukowców skupionych w grupie ADR Technology. Skuteczność ich działania potwierdzona jest przez polskie placówki naukowo – badawcze jak i przez tysiące zadowolonych użytkowników.

Produkty ADR wytwarzane są w Polsce przez firmę **ADR System**. Dystrybucję prowadzi firma **Biomagnetica Polska**. Oryginalne Produkty ADR oznaczone są logo firm:

 **ADR Technology** *ADR System*

 **BIOMAGNETICA**

Dysk ADR-4



ADR-4 to urządzenie medyczne klasy I posiadające europejski atest CE.


ADR-4 można stosować na dwa sposoby:

- ① jako urządzenie do magnetoterapii (str. 2),
- ② jako dysk, który zmienia właściwości fizyczne wody na bardziej korzystne dla zdrowia (str. 3).

Używanie ADR-4 ma bardzo pozytywny wpływ na organizm i polecane jest zarówno profilaktycznie jak i w niektórych schorzeniach.

Obudowa wykonana jest z bezpiecznego dla zdrowia tworzywa posiadającego certyfikat dopuszczający je do kontaktu z żywnością.

Pomimo, że lecznicze właściwości stałego pola magnetycznego znane są od czasów starożytnych, a współczesna medycyna potwierdza ich skuteczność, dysk ADR-4 jest szczególnym przypadkiem stymulatora magnetycznego. Działa on bowiem jako urządzenie aktywno-pasywne – wewnątrz obudowy umieszczony jest dysk z ceramiki ADR, która pochłania pola elektryczne i niweluje ich wpływ, natomiast w samej ceramice zamocowane są aktywne elementy magnetyczne wytwarzające niejednorodne stałe pole magnetyczne. W trakcie badań stwierdzono, że tylko wspólne działanie tych dwóch elementów daje zaskakujący efekt zmian właściwości fizycznych wody na bardziej korzystne dla organizmów żywych.

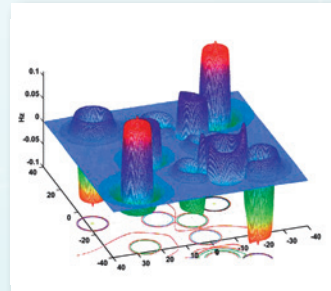

Przestrzenny rozkład stałego pola magnetycznego nad dyskiem ADR-4. Dysk wytwarza pole magnetyczne o natężeniu 30 gausów (3 militesle).

ADR-4 został skonstruowany w 1989 r. Po kilku latach testów w polskich i zagranicznych placówkach naukowo-badawczych został zaprezentowany na światowych wystawach wynalazczości, gdzie zdobył bardzo prestiżowe nagrody (str. 13). Skuteczność ADR-4 jest udowodniona nie tylko laboratoryjnie i klinicznie, lecz przede wszystkim przez tysiące zadowolonych użytkowników.

ADR-4 ma 9,5 cm średnicy i 1,7 cm grubości, waży ok. 120g. Nie wymaga baterii ani zasilania.

1 ADR-4 jako urządzenie do magnetoterapii

Podstawowym zastosowaniem urządzenia medycznego ADR-4 jest stymulacja magnetyczna ciała. Wykonuje się ją poprzez przystawianie dysku do chorego miejsca **stroną z napisem „ADR-4”**. Natężenie pola magnetycznego dysku jest celowo obniżone, co czyni go bezpiecznym w użytku domowym, lecz może niekiedy wydłużać oczekiwanie na pożądany efekt.

ADR-4 stosuje się w przypadku różnych dolegliwości, np.:

- ✓ bóle stawów, mięśni, kręgosłupa, nerwobóle,
- ✓ fibromialgia, neuropatia cukrzycowa,
- ✓ stymulacja zwichniętych stawów, złamań,
- ✓ stymulacja stawów w chorobie reumatycznej,
- ✓ przyspieszanie gojenia i regeneracji tkanek,
- ✓ stymulacja miejsc ze stanami zapalnymi.

Przeciwwskazania do używania ADR-4, jako urządzenia do magnetoterapii

- ✓ ADR-4 jako stymulatora magnetycznego nie mogą używać osoby z chorobą nowotworową.
- ✓ Rozrusznik serca.
- ✓ Osoby z implantami metalowymi nie mogą przystawiać do nich ADR-4. Odległość pomiędzy stosowanym dyskiem i implantem powinna wynosić min. 30 cm.

Zastosowanie

Bóle, stany zapalne: dysk należy przykładać **stroną z napisem** do bolącego miejsca. Czas stymulacji jest różny w zależności od jej celu. Przykładowo, bóle dużych stawów czy kręgosłupa będą wymagały dłuższej stymulacji niż stawy dłoni. Jednakże przeciętnie zalecane jest 2-3 sesje po ok. 10-20 minut dziennie.

Zwichnięcia, złamania, chore tkanki, rany: dysk można na długi czas lub nawet na stałe umieścić w opatrunku.

Bóle głowy: wielu użytkowników zgłasza, że stymulacja magnetyczna pomaga im w szybkim pozbyciu się bólów głowy. Stymulację taką powinno stosować się ok. 5-10 minut.



② ADR-4 jako dysk do zmiany właściwości fizycznych wody

Drugim sposobem zastosowania ADR-4 jest używanie go do zmiany właściwości fizycznych wody w napojach i pokarmach. Pole wytwarzane przez dysk porządkuje strukturę wody na bardziej korzystną dla organizmów żywych. Zmiana taka jest wyczuwana przez około 80% osób jako lekka poprawa smaku, np. woda taka jest określana jako bardziej delikatna i jedwabista w stosunku do próbki nie poddanej działaniu dysku.

Regularne stosowanie ADR-4 jest ważnym uzupełnieniem codziennej profilaktyki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że stosowanie ADR-4, pomimo wysokiej wartości profilaktycznej, **nie zastępuje leczenia konwencjonalnego** a jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń równowagi organizmu i poprawę ukrwienia obwodowego.



Atesty i badania

Na rynku lub w sieci można znaleźć produkty podobne do ADR-4. Przeważnie leczą one prawie wszystko, lecz ich sprzedawcy, poza długą listą „cudownych wyleczeń”, nie są w stanie udowodnić skuteczności działania poprzez przedstawienie badań klinicznych i atestów medycznych.

Stymulator magnetyczny ADR-4 posiada wszystkie wymagane atesty i jest zarejestrowany jako urządzenie medyczne klasy I. Klientów informujemy wyłącznie o rzeczywistym, udowodnionym działaniu stymulatora. Poniżej wymieniamy ważniejsze atesty, a na kolejnych stronach są streszczenia niektórych badań (ich pełne wersje są na naszej stronie internetowej).


- ✓ Świadectwo Instytutu Leków Nr MM-0576/IL – po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zastępuje je znak CE i rejestracja ADR-4 jako urządzenia medycznego Klasy I, nr PL/DR 009937;
- ✓ Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
- ✓ Opinia Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej i Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu;
- ✓ Niemieckie świadectwo TÜV dopuszczające ADR-4 do kontaktu z żywnością;
- ✓ Potwierdzenie własności detoksykacyjnych przeprowadzone przez Trace Elements, Inc., USA.

Do tej pory badania ADR-4 w Polsce zostały przeprowadzone m.in. w:

- ✓ Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej oraz Zakładu Radiologii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu,
- ✓ Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Wskazania do spożywania wody zmienionej przez ADR-4

Dla polepszenia krążenia obwodowego i poprawy wydolności.

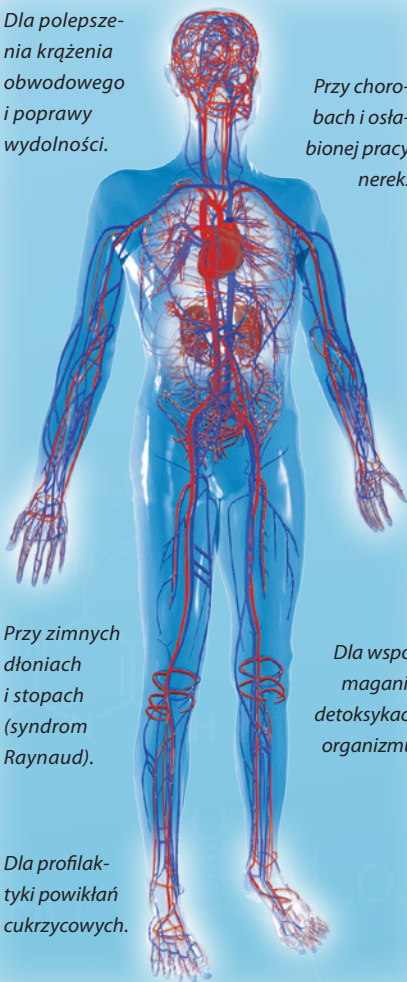

Przy chorobach i osłabionej pracy nerek.

Przy zimnych dłoniach i stopach (syndrom Raynaud).

Dla wspomagania detoksykacji organizmu.

Dla profilaktyki powikłań cukrzycowych.

- ✓ choroby, upośledzenia czynności nerek,
- ✓ zaburzenia krążenia obwodowego,
- ✓ choroba Raynaud (zimne dłonie, stopy),
- ✓ dla poprawy wydolności organizmu,
- ✓ zaburzenia równowagi czynnościowej,
- ✓ usuwanie metali ciężkich i toksyn,
- ✓ profilaktyka powikłań cukrzycowych na tle degeneracji naczyń krwionośnych (np.: stopa cukrzycowa, trudno gojące się rany).

Przeciwwskazania do używania ADR-4 do stymulacji wody

Nie stwierdzono. Produkt jest na rynku od ponad 17 lat i przez ten czas nie zarejestrowano żadnego przypadku negatywnego wpływu ADR-4 na zdrowie.

Obserwacje użytkowników

Cukrzyca – wielu użytkowników ADR-4 chorujących na cukrzycę zauważa znaczne uregulowanie się poziomu cukru i ciśnienia, co często pozwala zmniejszyć dawki leków. ADR-4 korzystnie wpływa na poprawę krążenia obwodowego, co może być wykorzystane w profilaktyce powikłań cukrzycy (stopa cukrzycowa, uszkodzenia nerek, trudno gojące się rany, itp.).

Obrzęki – użytkownicy donoszą też o skuteczności stosowania ADR-4 przy obrzękach

i opuchnięciach – zwłaszcza nóg u osób starszych lub chorujących na nerki.

Poprawa krążenia obwodowego – osoby z marznącymi stopami lub dłońmi (zespół Raynaud) najszybciej zauważają poprawę. Niekiedy już po tygodniu regularnego stosowania ADR-4 widzą istotną poprawę ukrwienia oraz ciepłoty dłoni i stóp. użytkownicy donoszą też o skuteczności stosowania ADR-4 przy obrzękach i opuchnięciach – zwłaszcza nóg u osób starszych lub chorujących na nerki.

ADR-4 w chorobach układu krążenia

ADR-4 jest skuteczny we wspomaganiu leczenia zaburzeń krążenia (w tym zespołu Raynaud – marnzące dłonie i stopy). Efekty pojawiają się zwykle po 1-4 tygodniach stosowania.


Typowy wynik poprawy ukrwienia obwodowego z badań u grupy osób z objawem Raynaud:

A – przed zastosowaniem ADR-4;

B – po tygodniu stosowania ADR-4.


Zdjęcie termograficzne – kolory jaśniejsze oznaczają wyższą temperaturę ciała (lepsze ukrwienie).

Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.*

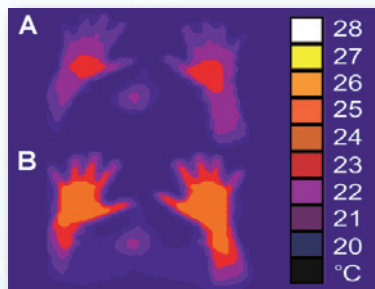

ADR-4 we wspomaganiu detoksykacji organizmu

ADR-4 podnosi zdolność organizmu do oczyszczania się z toksyn i metali ciężkich. Polecany jest dla zamieszkujących lub pracujących w środowisku skażonym.

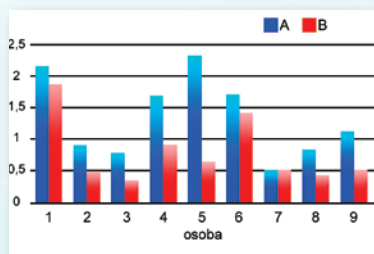

Wynik badania zawartości aluminium (metal toksyczny) w organizmie człowieka. Test wykonany metodą analizy włosów.


A – wynik pierwszego badania,

B – po miesiącu stosowania ADR-4.

Badanie przeprowadzono w firmie Trace Elements Inc., USA.

ADR-4 w chorobach i dysfunkcjach nerek

U osób z chorobami nerek stosujących ADR-4 badania wykazały statystycznie istotną poprawę filtracji, ekstrakcji, transportu nerkowego, wskaźnika odpływu oraz diurezy.

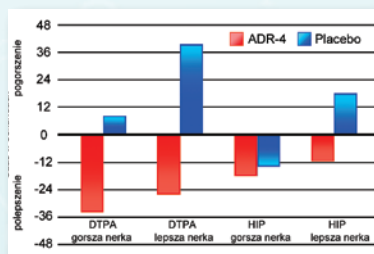

Badanie skrócenia średniego czasu transportu nerkowego w grupach osób używających aktywny ADR-4 i atrapę. Znak minus (skrócenie czasu wytwarzania moczu) oznacza poprawę czynności nerek.

Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.*

* Pełny raport z badania na www.biomagnetica.pl.



Użytkowanie ADR-4

Dysk należy położyć napisem „ADR-4” ku górze i postawić na nim szklankę z napojem lub talerz z posiłkiem na ok. 3-4 minuty. Kilkulitrowe butelki, kartony czy naczynia należy pozostawić na ok. 10-15 minut. Płyn należy wstrząsnąć lub zamieszać przed postawieniem na ADR-4. Herbaty, napary ziołowe czy kawę najlepiej zaparzać już na dysku – będą one bogatsze w składniki, a ich smak będzie głębszy. Koneserzy czują różnicę w smaku wina postawionego wcześniej na ADR-4.

Najlepiej używać dysku tuż przed spożyciem. Każda kolejna obróbka pokarmu czy napoju (gotowanie, smażenie, czy nawet wstawienie go do lodówki lub w pobliżu urządzenia elektrycznego) spowoduje kolejną zmianę właściwości wody – należy ponownie użyć ADR-4.

Na ADR-4 należy stawiać naczynia ceramiczne, szklane, lub plastikowe. **Należy unikać naczyń metalowych**, które zaburzają działanie dysku. Nie można na nim stawiać dużych naczyń o temperaturze powyżej 80°C, gdyż mogą odkształcić plastikową obudowę.

Zarówno w przypadku wymienionych wcześniej przypadłości jak i dla profilaktyki, ADR-4 powinno się używać przynajmniej 2-3 razy dziennie. Zaletą dysku jest prostota i powtarzalność stosowania. Najlepiej stawiać na nim wszystko co spożywamy (każdy pokarm, oprócz oleju, zawiera przynajmniej 30% wody). Można więc stawiać na nim np.:

- ✓ napoje, herbatę, kawę, soki, wino,
- ✓ mleko, jogurt, maślanek, nabiał,
- ✓ zupy, buliony, wywary,
- ✓ ugotowane ziarna (ryż, kasze),
- ✓ warzywa świeże i gotowane,
- ✓ owoce, koktajle owocowe,
- ✓ inne produkty spożywcze.

Nawet jeżeli na ADR-4 będziemy stawiać wszystko co jemy i pijemy, nie zachodzi możliwość „przedawkowania”. Dysk zmienia właściwości fizyczne wody na bardziej korzystne dla naszego organizmu. Nie powoduje on żadnych zmian chemicznych czy zmian składu napojów i pokarmów.



Dbanie o ADR-4

ADR-4 można myć płynem do mycia naczyń, płukać pod bieżącą wodą, myć w zmywarce.



Otworzenie dysku jest równoznaczne z jego zniszczeniem. Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Zapewniamy efektywne działanie przez 5 lat od daty zakupu. Po tym czasie dysk słabnie i należy nabyć nowy ADR-4. Stary dysk można używać tam, gdzie nie zależy nam na czasie – do wody odstawionej dla kwiatów, w beczce z deszczówką do podlewania roślin, oczku wodnym lub też zakopać pod korzeniami dużej rośliny (doniczkowej, ogrodowej). ADR-4 ma korzystny wpływ na rośliny. Potwierdzają to badania dokonane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (więcej na biomagnetica.pl).

Zasada działania ADR-4

Zmiany w wodzie wywoływane przez ADR-4: ✓ obniżenie napięcia powierzchniowego (zwiększa zdolność zwilżania); ✓ zwiększanie stopnia agregacji (rozdrobienia) pozlepianych cząsteczek wody; ✓ zmiana przenikalności elektrycznej; ✓ zmiana przewodnictwa elektrycznego; ✓ zmiana własności biologicznych.


Tylko samo obniżenie napięcia powierzchniowego (woda staje się bardziej miękka) ułatwia przenikanie składników odżywczych i tlenu do komórek oraz wydalanie produktów przemiany materii. Ma to wpływ na vitalność, wydolność i odporność organizmu. Podobnie jak w przypadku prania, im twardsza woda, tym więcej proszku i energii musimy na nie zużyć, tak i w organizmie twarda woda utrudnia wymianę składników na poziomie komórkowym. Niestety w Polsce mamy przeważnie twardą wodę.

Dodatkowym czynnikiem mającym niekorzystny wpływ na właściwości biologiczne wody są **poła elektryczne zmienne**. Pola takie wytwarzają wszystkie urządzenia elektryczne, w tym.: lodówka, kuchenka mikrofalowa lub elektryczna, piekarnik, czajnik elektryczny, itd. W wodzie znajdującej się w zasięgu takich pól powstają ugięcia, osłabienie, a nawet zrywanie wiązań wodorowych. Powodują one także zlepianie klasterów wody w bardzo duże skupiska, co wprowadza chaos w strukturze cieczy. Zupełnie przeciwnie działa **stałe pole magnetyczne** – zwiększa siłę wiązań wodorowych i porządkuje strukturę wody. Wytwarza je właśnie ADR-4.

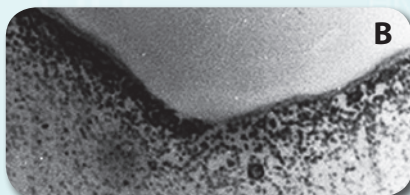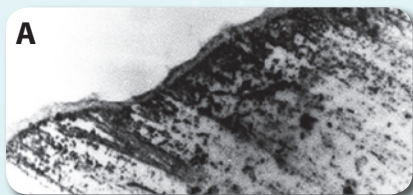

Mikroskopowy obraz brzegów dwóch kropli wody mineralnej „Staropolanka” po odparowaniu: A – woda bez wpływu ADR-4, B – woda po działaniu ADR-4.

Wpływ ADR-4 spowodował zmiany (uporządkowanie) w krystalizacji rozpuszczonych w wodzie składników. Zdjęcia wykonano na Politechnice Gdańskiej, powiększenie 1300×.

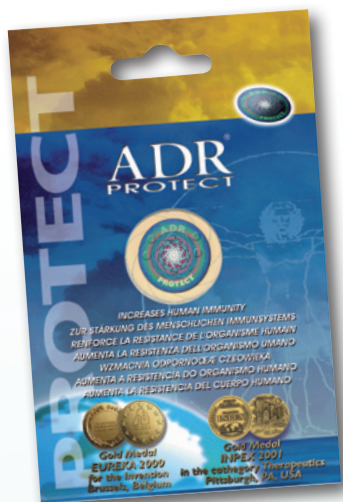

ADR Protect

ADR Protect to miniaturowy osobisty stymulator magnetyczny. Posiada europejski certyfikat CE jako urządzenie medyczne klasy I oraz Atest Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

ADR Protect ma średnicę monety 2 zł i grubość ok. 1 mm. Działa poprzez kontakt z ciałem. Delikatnie stymuluje przywspółczulny układ nerwowy, przez co wspomaga utrzymanie równowagi organizmu oraz podnosi odporność na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych. W szczególności dotyczy to pól elektromagnetycznych, które mogą powodować zaburzenia pracy systemu nerwowego. Źródłem takich pól jest sieć elektryczna i wszystkie urządzenia elektryczne (elektroniczne), także telefony komórkowe.

ADR Protect nie zmniejsza oddziaływania źródeł promieniowania (przykładowo: nie hamuje emisji fal telefonu komórkowego). Podnosi odporność człowieka na zaburzenia powodowane m.in. przez pola elektromagnetyczne i przyspiesza powrót do stanu równowagi.


ADR Protect działa średnio 2-4 lata (w zależności od miejsca naklejenia, sposobu i intensywności użytkowania). Jeżeli warstwy ADR Protect przesuwiają się w stosunku do siebie lub rozwarstwiają, należy wymienić go na nowy.

Wskazania

- ✓ przebywanie w środowisku skażonym wpływem pól elektromagnetycznych (np.: praca przy urządzeniach elektrycznych, częste używanie komputera lub telefonu komórkowego),
- ✓ kłopoty z krążeniem obwodowym,
- ✓ obniżona wydolność lub odporność organizmu,
- ✓ intensywny wysiłek fizyczny (sportowcy),
- ✓ wiek podeszły.

Przeciwwskazania

ADR Protect jest stymulatorem magnetycznym o tak znikomych rozmiarach i sile oddziaływania, że nie stanowi żadnego zagrożenia nawet dla osób, u których stosowanie pól magnetycznych nie jest wskazane, posiadających rozrusznik serca lub metalowe implanty.



Przestrzenny obraz pola magnetycznego wytwarzanego przez ADR Protect (siła 2,4 gaussa).

Sposób użycia

ADR Protect należy wyjąć z opakowania i oderwać od instrukcji obsługi. Następnie **zerwać spod niego miodowy papierek**, pod którym znajduje się biała warstwa kleju. Dopiero teraz można nakleić ADR. Należy dobrze wybrać miejsce naklejenia, ponieważ klej jest silny i próba oderwania ADRa może spowodować jego uszkodzenie (rozwarstwienie folii).

ADR Protect powinien dotykać skóry lub być od niej nie dalej jak 2 mm.

Przykleić go można np.: pod zegarek, na wkładkę w butcie, na telefon, myszkę komputera, medalion noszony na piersiach (pod ubraniem).




Badania wykazały, że ADR Protect dotykając dowolnego punktu ciała daje efekt ogólnoustrojowy. Przykładowo: ADR Protect przyklejony pod zegarek czy na wkładkę w butcie oddziałuje nie tylko na jedną rękę czy nogę lecz na całe ciało.

Najefektywniejsze jest używanie go kilka godzin dziennie. Radzimy jednak na noc robić przerwę w stosowaniu ADR Protect aby organizm nie przyzwyczał się zbyt do ciągłej stymulacji.

ADR Protect w poprawie krążenia obwodowego

ADR Protect poprzez wpływ na autonomiczny układ nerwowy jest w stanie poprawić pracę układu krążenia. Prawidłowe ukrwienie to jeden z objawów równowagi organizmu.

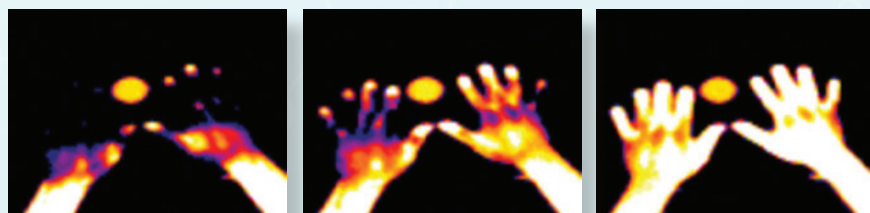

0 sek

80 sek

640 sek

Wyniki badania zmian ukrwienia dłoni pod wpływem ADR Protect (umieszczony pod jedną z dłoni). Badanie przeprowadzone metodą termograficzną u pacjenta z chorobą Raynaud (im jaśniejszy kolor tym wyższa temperatura): A – przed zastosowaniem; B – w trakcie stosowania.


Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Pełny raport z badania w dziale „Czytelnia” na www.biomagnetica.pl

Maty ADR – nowoczesna ochrona przed elektrosmogiem

Po latach pracy i setkach doświadczeń polscy naukowcy z ADR Technology jako **pierwsi na świecie** stworzyli technologię, która pozwala bardzo skutecznie i tanio chronić środowisko domu i pracy człowieka przed wpływem elektrosmogu. Nowatorska Technologia ADR oparta jest na niwelacji pól elektrycznych za pomocą... wody. W przeciwieństwie do innych ekranów opartych na materiałach przewodzących, Maty ADR są niezwykle proste w użyciu i znacznie tańsze. Ich szczególną zaletą jest to, że nie wymagają uziemienia.

Maty ADR w ponad 90% niwelują szkodliwe pola elektryczne, zarówno pochodzenia sztucznego (sieć elektryczna) jak i naturalnego (od cieków wodnych). Pochłoniętą energię zamieniają w drganie cząsteczek wody a tak powstały ruch wytwarza ciepło. Niekorzystna energia pola elektrycznego zamieniana jest w nieszkodliwą energię cieplną (oczywiście mowa tu o zjawiskach na poziomie cząsteczkowym – ekrany ADR nie grzeją).

Maty ADR stosuje się wszędzie tam, gdzie na człowieka długotrwale wpływają pola elektryczne, szczególnie w miejscu snu, pracy lub wypoczynku. Najczęstszymi objawami występowania pól elektrycznych w miejscu snu są: zaburzenia snu (i ich liczne konsekwencje), pogorszone samopoczucie, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia pracy układu nerwowego (np.: drażliwość, rozkojarzenie) Stosowanie ich jest ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej współczesnego człowieka. W wielu przypadkach samo zneutralizowanie wpływu zmiennych pól elektrycznych przynosi w krótkim czasie znaczną poprawę samopoczucia. Szczególnie ważna jest ochrona przed polami elektrycznymi w miejscu snu, gdyż występujące tam pola godzinami oddziałują na śpiącego człowieka, co może zaburzać sen i zachodzące podczas niego ważne dla zdrowia procesy.

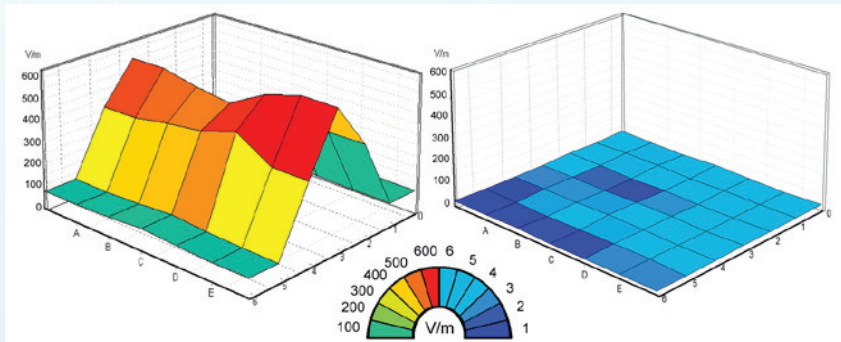

*Przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego wytwarzanego przez końcówkę rozgałęziacza podpiętego do sieci. Natężenie mierzone w voltach na metr, badane pole zostało podzielone na kwadraty o bokach 5 cm. **Wykres lewy** – natężenie pola elektrycznego dochodzi do ponad 600 V/m.*

***Wykres prawy** – pomiar po nakryciu rozgałęziacza Matą ADR – maksymalne natężenie pola ok. 5 V/m.*

**natężenie pola mierzono w odległości 5 cm od źródła*



Rozmiary **Mat ADR do łóżek**:

- ✓ dziecięcych – **Mata M** (1,2 × 0,6 m)
- ✓ jednoosobowych – **Mata L** (2 × 0,9 m)
- ✓ dwuosobowych – **Mata XL** (2 × 1,5 m)

Maty ADR do łóżek

Mata ADR do łóżek to ekran chroniący przed polami elektrycznymi podczas snu. Matę kładziemy pod materac łóżka lub pod nakładkę (koc) na materac. Nie powinno się umieszczać jej bezpośrednio pod prześcieradło, gdyż może to skrócić jej żywotność. Jest nieprzesiąkająca ale paroprzepuszczalna. Nie powoduje odparzeń, odleżyn, zaczerwienień czy zapoaceń skóry. Jest bezpieczna dla alergików.

Maty nie można prać w pralce. Zabrudzoną Matę można przemyć gąbką nasączoną wodą z niewielką ilością detergentu.

Udzielamy gwarancji na rok od daty zakupu. Okres trwałości niepranej Maty to 5 lat.

- ✓ W celu ochrony przed polami pochodzenia naturalnego (tzw. ciekli wodne) oraz ze źródeł z otoczenia łóżka, Matę umieszczamy pod materacem.
- ✓ W przypadku źródeł pola powyżej materaca, umieszczamy ją w poszwie kołdry.
- ✓ Mata ADR działa najefektywniej jeżeli jest umieszczona na linii źródło pola – człowiek. Pochłania też pola elektryczne pochodzące od innych źródeł.
- ✓ Jeżeli przy łóżku znajduje się dużo urządzeń i okablowania, np. biurko z komputerem czy telewizor z zestawem kina domowego, można po prostu na noc nakrywać je Matą.



Pola elektryczne przemienne występują także w naturze, np. zmiany w atmosferze przed burzami (wywołują u ludzi poczucie ciężkości, senności, zmęczenia, itp.). Innym przykładem wytwarzania takich pól elektrycznych są ruchy wód płynących pod ziemią. Wody takie niosą ze sobą jony minerałów (cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym), które przemieszczając się z wodą wytwarzają pola elektryczne, które od wieków znane są jako szkodliwe promieniowanie cieków wodnych.

Efekt przestrajania

Zmiana środowiska energetycznego może u niektórych powodować przez pierwsze noce różne nietypowe objawy jak: kłopoty ze snem, nadpobudliwość, lekkie przyśpieszenie pulsu. Jest tak, gdy miejsce snu było mocno skażone polami elektrycznymi lub u osób z zaburzoną równowagą organizmu (np.: w cukrzycy). Należy wtedy stosować Matę stopniowo, np. rozłożyć ją pod 1/3 materaca, po dwóch dniach pod 1/2, po kolejnych dniach pod całym.

Maty ADR – ekrany ochronne



Maty Eco rozmiar 35 × 35 cm
✓ powłoka Iniana

Maty Eco

Maty Eco jest grubsza i sztywniejsza. Warstwa pianki oddechającej nadaje jej miękkość, a warstwy lnu czynią ją w dotyku. Matę umieszcza się pod poduszką, pod laptopem, na siedzisku krzesła lub też pomiędzy dowolnym źródłem pola a człowiekiem.

Maty nie można prać w pralce. Zabrudzoną Matę można przemyć gąbką nasączoną wodą z niewielką ilością detergentu.

Udzielamy gwarancji na rok od daty zakupu. Okres aktywności niepranej Maty to 5 lat.

Maty złożona pod laptopem jest w stanie obniżyć o ponad 90% natężenie pól elektrycznych występujących w jego bliskim otoczeniu i nad klawiaturą. Stosowanie jej szczególnie polecane jest osobom podróżującym oraz które używają laptopa kładzionego na ciele. Zapobiega ona także powstawaniu pól błędzących, które rozchodzą się po powierzchni ciała, ubrania, mebla.

Matę można umieścić na siedzisku krzesła lub fotela stojącego w miejscu pracy, podczas której używamy urządzeń elektrycznych. Urządzenia te powodują powstawanie na ciele, ubraniu i krześle tzw. ładunków błędzących. Maty pochłania takie ładunki.



Rozmiary rolek **Maty TEX**
✓ 0,14 × 1 m (1,4 m²)
✓ 1,5 × 25 m (25 m²)
✓ 1,5 × 50 m (50 m²)

Maty ADR TEX

Maty TEX przeznaczona jest zarówno do użytku domowego, biurowego, jak i dla budownictwa oraz przemysłu. Z powodu coraz większego skażenia środowiska człowieka przez wpływy pól elektrycznych, Maty TEX znajdują coraz więcej nowych zastosowań.

Maty TEX można umieszczać np.: pod panelami podłogowymi i ściennymi, wykładzinami, tapetami, w ściankach działowych, pod ociepleniem dachowym, w tapicerce mebli, itd. Jej zaletą jest lekkość, cienkość, łatwość montażu, możliwość cięcia jak zwykle płótno, niska cena.

ADR Primer – w przygotowaniu

Naukowcy z ADR Technology nie odpoczywają i pracują obecnie nad nowym wynalazkiem – **ADR Primer**. To płyn gruntujący do ścian i podłóg, który ekranuje pola elektryczne – można powiedzieć ekran w płynie. Po raz kolejny polscy naukowcy tworzą coś szczególnego na skalę światową. Obecnie produkt jest w końcowej fazie atestów.

Nagrody dla produktów ADR

Złote Medale dla ADR-4 i ADR Protect.
49. Światowy Salon Innowacji Brussels Eureka 2000, Belgia



Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie nadany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 1998, Polska



Srebrny Medal dla ADR-4 przyznany na 2. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 1999, Polska



ADR-4 – Złoty Medal (Ochrona zdrowia)
ADR Protect – Srebrny Medal (Dla domu).
15. Światowy Zjazd Geniuszów, Japonia, 2001.



Maty ADR – Złoty Medal w kategorii „Ochrona Środowiska” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Genewa 2011, Szwajcaria.



Złoty Medal dla ADR-4 i Złota Statuetka – nagroda specjalna przyznana przez Instytut Wspólnoty Europejskiej dla Promocji Przedsięwzięć Handlowych.
47. Światowy Salon Innowacji Brussels Eureka 1998, Belgia



ADR-4 – Grand Prix, Srebrny Medal (Terapia), Brązowy Medal (Nauka).
ADR Protect – Złoty Medal (Terapia).
17. Światowe Targi Innowacji Technicznych INPEX, 2001, USA





BIOMAGNETICA
POLSKA

ul. Górczewska 228 b/u7

01-460 Warszawa

tel. 22 397 77 02

tel./fax 22 304 98 65

Biuro czynne pn. - pt. 9.00 - 16.00

biuro@biomagnetica.pl

www.biomagnetica.pl